



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 60526

Срок действия до 18 ноября 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ТЕСЕЙ" (ООО "ПК "ТЕСЕЙ"), г. Обнинск, Калужская обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **62293-15**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 62293-15

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года - для ТППТ с температурой применения от 0 до 1100 °С, для ТПРТ с температурой применения от 600 до 1200 °С; 1 год - для ТППТ с температурой применения свыше 1100 до 1300 °С, для ТПРТ с температурой применения свыше 1200 до 1600 °С; для остальных датчиков - первичная поверка до ввода в эксплуатацию

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **18 ноября 2015 г. № 1398**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



"26" 11 2015 г.

Серия СИ

№ 022842

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex

Назначение средства измерений

Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex (далее – датчики температуры) предназначены для измерений температуры жидких и газообразных и сыпучих сред, не агрессивных к материалу защитного корпуса.

Описание средства измерений

Принцип действия датчиков температуры основан на термоэлектрическом эффекте – генерировании термоэлектродвижущей силы (ТЭДС), пропорциональной разности температур рабочего конца и свободных концов двух проводников (термоэлектродов) из различных металлов или сплавов.

Датчики температуры состоят из одного, или нескольких конструктивно связанных, первичных преобразователей температуры, защитного корпуса с монтажными элементами или без них и коммутационных устройств в виде клеммной головки, коробки, разъема или удлиняющих проводов.

Первичный преобразователь датчиков температуры выполнен в виде проволочной или кабельной термопары.

Проволочная термопара представляет собой керамическую соломку или бусы с размещёнными внутри нее одной, двумя или тремя парами термоэлектродов, расположенными параллельно друг другу. Материал соломки и бус – алюмооксидная керамика. Термоэлектроды проволочной термопары со стороны рабочего торца попарно сварены между собой, образуя один, два или несколько рабочих спаев. Проволочная термопара помещена в защитный корпус, также имеются исполнения без защитного чехла. Свободные концы термоэлектродов подключаются к клеммам головки датчика температуры или к удлиняющим проводам.

Кабельная термопара представляет собой гибкую металлическую трубку с размещёнными внутри нее одной, двумя или тремя парами термоэлектродов, расположенными параллельно друг другу. Пространство вокруг термоэлектродов заполнено уплотненной мелкодисперсной минеральной изоляцией. Термоэлектроды кабельной термопары со стороны рабочего торца попарно сварены между собой, образуя один, два или три рабочих спая. Рабочий торец заглушен с помощью сварки, либо имеет открытый спай. Свободные концы термоэлектродов подключаются к клеммам головки датчика температуры или к удлиняющим проводам.

В клеммную головку или коробку могут устанавливаться измерительные преобразователи (ИП). ИП преобразуют сигнал от первичного преобразователя в унифицированный выходной сигнал постоянного тока по ГОСТ 26.011-80 и (или) цифровой сигнал по протоколу HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus.

В датчики температуры с клеммными головками, предусматривающих визуализацию результатов измерений, встраивается дисплей.

Номинальная статическая характеристика (НСХ) датчиков температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex – в соответствии с ГОСТ Р 8.585-2001, а ТПВР (тип С) – в соответствии с ASTM E230/E230M-12.

Модификации и схема обозначения датчиков температуры представлены в таблице 1.

Таблица 1

ТППТ	R	xx.xx	x		1	H	x	И		x	x	x	/	x	/	x
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

№ поля	Описание поля	Код поля	Расшифровка	
1	Тип датчика	ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex	Термопреобразователь, <u>тип</u>	
2	НСХ первичного преобразователя (ПП)	Не заполнено	ТПП (S) по ГОСТ Р 8.585-2001	ТППТ
		R	ТПП (R) по ГОСТ Р 8.585-2001	
		Не заполнено	ТПР (B) по ГОСТ Р 8.585-2001	ТПРТ
		Не заполнено	ТВР (C) по ASTM E230	ТПВР
		A1, A2, A3	ТВР (A-1), ТВР(A-2), ТВР(A-3) по ГОСТ Р 8.585-2001	
3	Конструктивная модификация	Согласно Руководству по эксплуатации (РЭ)		
4	Кабельный ввод			
5	Узел коммутации			
6	Диаметр термоэлектродов			
7	Класс допуска ПП	1, 2, 3	Согласно таблицы 3	
8	Вид выходного сигнала	Не заполняется	Сигнал ТЭДС в соответствии с НСХ	
		T	4÷20 мА	
		H	4÷20 мА + HART	
		P	Profibus	
		F	Fieldbus	
		W	Wireless HART	
9	Условное обозначение точности датчика температуры с ИП	15 – 100	Согласно таблицы 4	
10	Исполнение рабочего спая ПП	И, О	Изолированный спай	
			Открытый спай только для 01.01	
11	Количество ПП в одном изделии	Не заполнено	Один первичный преобразователь	
		№	№ первичных преобразователей	
12	Материал наружной оболочки	Согласно Руководству по эксплуатации (РЭ)		
13	Наружный диаметр рабочей части d, мм			
14	Монтажная длина датчика, мм			
15	Вспомогательный размер, мм			
16	Характерный геометрический параметр			

Фотографии общего вида датчиков температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ех, ТПРТ Ех приведены на рисунке 1.

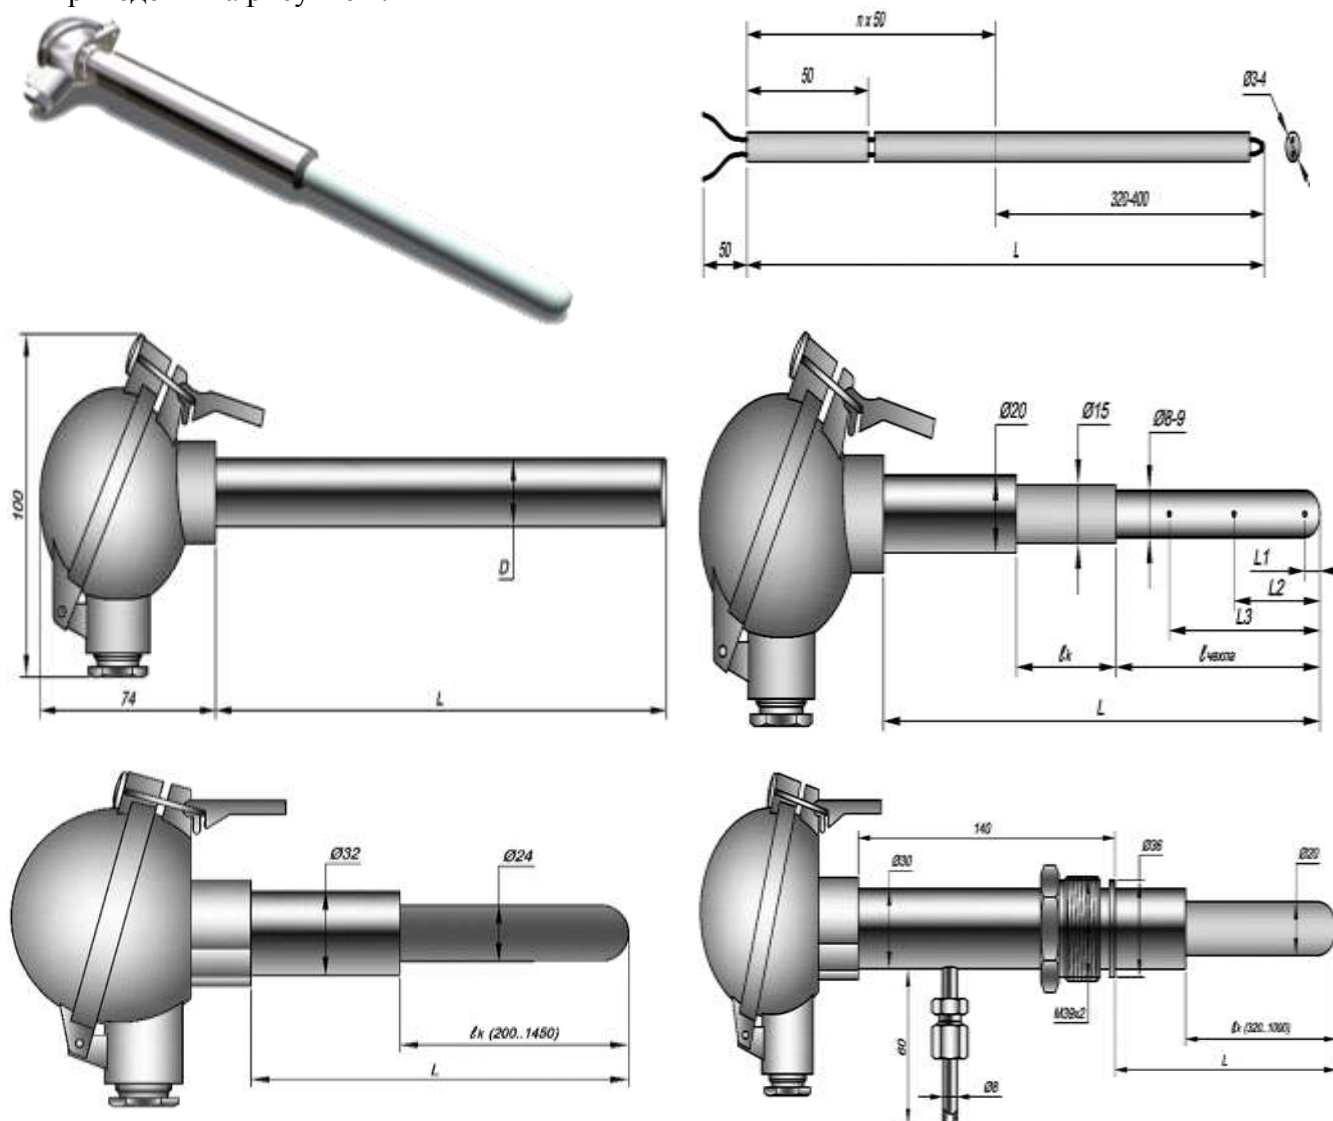


Рис.1 – Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ех, ТПРТ Ех

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) датчиков температуры состоит только из встроенной в корпус измерительных преобразователей метрологически значимой части ПО.

Идентификационные данные встроенной части ПО представлены в таблицах 2÷6.

Таблица 2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО (4ч20 мА)	tok.bin
Номер версии (идентификационный номер) ПО (*)	6.13.1002
Цифровой идентификатор программного обеспечения	по номеру версии

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО (4ч20 мА+HART)	hart.bin
Номер версии (идентификационный номер) ПО (*)	6.13.1002
Цифровой идентификатор программного обеспечения	по номеру версии

Таблица 4.

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО (Profibus)	profibus.bin
Номер версии (идентификационный номер) ПО (*)	1.20.1006
Цифровой идентификатор программного обеспечения	по номеру версии

Таблица 5.

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО (Fiedbus)	fieldbus.bin
Номер версии (идентификационный номер) ПО (*)	1.0.291
Цифровой идентификатор программного обеспечения	по номеру версии

Таблица 6.

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО (Wireless HART)	wireless.bin
Номер версии (идентификационный номер) ПО (*)	1.00.1
Цифровой идентификатор программного обеспечения	по номеру версии

Примечание к таблицам 2÷6: (*) – и более поздние версии.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» (в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014) - ПО защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики датчиков температуры ТПТТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex без ИП приведены в таблице 7.

Таблица 7

Тип датчика температуры	Условное обозначение НСХ	Диапазон измерений ⁽¹⁾ , °С		Класс допуска первичного преобразователя	Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ, °С
		от	до		
ТППТ ТППТ Ex	S, R	0	1100	1	± 1,0
		св. 1100	1600		± (1,0 + 0,003·(t-1100))
		0	600	2	± 1,5
		св. 600	1600		± 0,0025·t
ТПРТ ТПРТ Ex	B	600	1800	2	± 0,0025·t
		600	800	3	± 4,0
		св. 800	1800		± 0,005·t
ТПВР	C A-1, A-2, A-3	600	1800	3	± 0,01·t
		1000	1800	2	± 0,005·t
		1000	1800	3	± 0,007·t

Примечание к таблице 7:

⁽¹⁾ – Указаны предельные значения, конкретный диапазон, в зависимости от конструктивной модификации и наличия ИП, указан в паспорте и приводится на шильдике датчика.

Метрологические характеристики датчиков температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex с выходным сигналом постоянного тока и (или) цифровым сигналом по протоколам HART, Profibus, Fieldbus, Wireless HART приведены в таблице 8.

Таблица 8

Тип датчика температуры	Вид выходного сигнала и условное обозначение точности датчика температуры с ИП согласно таблице 1	Диапазон измерений t_n , °С	Пределы допускаемой основной погрешности, °С
ТППТ ТППТ Ex	H30, F30, P30, W30	от 100 до 650	± 2 °С
		св. 650 до 1600	± 0,3 % (от t_n)
	H15, F15, P15	от 100 до 1000	± 1,5 °С
		св. 1000 до 1600	± 0,15 %
	T40	от 100 до 650	± 2,5 °С
		св. 650 до 1600	± 0,4 %
	T25	от 100 до 900	± 2,3 °С
		св. 900 до 1600	± 0,25 %
ТПРТ ТПРТ Ex	H60, F60, P60, W60	от 100 до 700	± 4,5 °С
		св. 700 до 1800	± 0,6 %
	H30, F30, P30, W30	от 100 до 700	± 2 °С
		св. 700 до 1800	± 0,3 %
	T60	от 100 до 750	± 4,5 °С
		св. 750 до 1800	± 0,6 %
	T40	от 100 до 650	± 2,5 °С
		св. 650 до 1800	± 0,4 %
ТПВР	H100, F100, P100	от 100 до 700	± 7 °С
		св. 700 до 1800	± 1 %
	T100	от 100 до 1000	± 10 °С
		св. 1000 до 1800	± 1 %

Примечания :

a)
$$t_n = t_{max} - t_{min}, ^\circ\text{C} \quad (1)$$

где t_{max} и t_{min} – верхний и нижний пределы диапазона измерений (указан в паспорте и приводится на шильдике датчика).

б) Пределы погрешности указаны для нормальных условий эксплуатации и учитывают вклад погрешности, вызванной автоматической компенсацией температуры холодных спаев.

Метрологические характеристики ИП, входящих в состав датчиков температуры, в зависимости от вида выходного сигнала и условного обозначения точности датчика температуры, приведены в таблице 9.

Таблица 9

Вид выходного сигнала и условное обозначение точности датчика температуры с ИП согласно таблице 1	Диапазон измерений t_n , $^\circ\text{C}$	Пределы допускаемой основной погрешности ИП ⁽¹⁾ , $^\circ\text{C}$
T100, T60, T40, T25	от 100 до 1800	$\pm 2,0$
H100, F100, P100, W100, H60, F60, P60, W60, H30, F30, P30, W30, H15, F15, P15	от 100 до 1800	$\pm 1,0$
Примечание к таблице 9: (¹) – допускается применение других ИП с погрешностями не хуже указанных		

Пределы допускаемой абсолютной погрешности внутренней автоматической компенсации температуры свободных (холодных) концов термопары, измерительным преобразователем, приведены в таблице 10.

Таблица 10

Вид выходного сигнала и условное обозначение точности датчика температуры с ИП согласно таблице 1	Пределы допускаемой погрешности, $^\circ\text{C}$
T25, T40, T60, T100, H100, F100, P100, H60, F60, P60, W60, H30, F30, P30, W30, H15, F15, P15	$\pm 0,5 ^\circ\text{C}$

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной отклонением окружающей температуры от нормальной (23 ± 5) $^\circ\text{C}$ на каждый 1 $^\circ\text{C}$, приведены в таблице 11.

Таблица 11

Вид выходного сигнала и условное обозначение точности датчика температуры с ИП согласно таблице 1	Диапазон измерений t_n , $^\circ\text{C}$	Пределы допускаемой дополнительной погрешности, %
T100, T60, T40, T25	от 100 до 1800	$\pm 0,01$ % (от диапазона измерений)
H100, F100, P100, H60, F60, P60, W60, H30, F30, P30, W30, H15, F15, P15	от 100 до 1800	$\pm 0,005$ %

Основные технические характеристики датчиков температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР приведены в таблице 12.

Таблица 12

Параметр	Значение
Напряжение питания ИП, В	от 8 до 35
Напряжение питания ИП, В (для Ex-исполнения)	от 8 до 30
Сопrotивление внешней нагрузки, Ом	от 0,1 до $R_{нагр} = (U_{питания} - 7,2)/0,023$
Электрическое сопротивление изоляции датчиков температуры, при температуре 25 ± 10 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 %, МОм, не менее	100
Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации по ГОСТ Р 52931-2008	Группа исполнений N2
Группы механического исполнения по ГОСТ 30631-99 и ГОСТ 17516.1-90	Группа исполнений М6
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	В зависимости от конструктивной модификации IP40 (для простого исполнения), IP55, IP65, IP66, IP68. Конкретная степень указывается в паспорте датчика.
Нормальные условия эксплуатации для датчиков с установленными ИП	Температура 23 ± 5 °С, относительная влажность не более 95 %
Рабочие условия эксплуатации для датчиков с установленными ИП	Температура от -55 до $+85$ °С, относительная влажность не более 98 %
Рабочие условия эксплуатации для датчиков с дисплеем.	Температура от -40 до $+85$ °С, относительная влажность не более 98 %
Рабочие условия эксплуатации для датчиков без ИП.	Температура от -60 до $+120$ °С, относительная влажность не более 98 %

На отдельном шильдике датчики температуры ТППТ Ex, ТПРТ Ex имеют маркировку вида 0ExiaIIST6X («искробезопасная электрическая цепь»).

Дрейф метрологических характеристик измерительных преобразователей не превышает значений, указанных в таблице 13.

Таблица 13

Время эксплуатации	Вид выходного сигнала и условное обозначение точности датчика температуры с ИП согласно таблице 1	Значение
2 года	H100, F100, P100, H60, F60, P60, W60, H30, F30, P30, W30, H15, F15, P15	$\pm 0,10$ % (от диапазона измерений)
	T100, T60, T40, T25	$\pm 0,15$ %

Показатели надежности датчиков (таблица 14) установлены в соответствии с ГОСТ 27883-88 и учитывают условия их эксплуатации.

Значения факторов, влияющих на датчики при эксплуатации и величины дрейфа первичных преобразователей, приведены в РЭ для конкретных конструктивных модификаций.

В зависимости от наличия и уровня приведенных факторов, условия эксплуатации разделены на группы и указаны в таблице 14.

Таблица 14

Группа условий эксплуатации	Вероятность безотказной работы	Средний срок службы	Гарантийный срок эксплуатации
II ¹	0,85 за 16 000 часов	4 года	2 год
III ¹	0,85 за 8 000 часов	2 года	1 год
IV	Не нормирована	Не нормирован	Не нормирован
¹ – эксплуатация датчиков температуры в окислительной и инертной атмосфере при отсутствии воздействия веществ, относящихся к платиновым ядам.			

Назначенный срок службы зависит от группы условий эксплуатации и равен интервалу между поверками (ИМП). При успешном прохождении датчиком температуры периодической поверки, назначенный срок службы продлевается на величину следующего ИМП. ИМП не нормирован для IV группы эксплуатации, т.е. первичная поверка до ввода в эксплуатацию.

В таблице 15 приведено соответствие температуры применения и групп условий эксплуатации.

Таблица 15

Тип датчика температуры	Температура применения ⁽¹⁾ , °C		Группа условий эксплуатации	Дрейф за ИМП ⁽²⁾ , °C, не более
	от	до		
ТППТ ТППТ Ex	0	1100	II	± 1
	св. 1100	1200	III	± (1,0 + 0,003·(t-1100))
	св. 1200	1300		± (0,002 t)
	св. 1300	1600	IV	-
ТПРТ ТПРТ Ex	600	1200	II	± (0,0025 t)
	св. 1200	1400	III	
	св. 1400	1600		IV
	св. 1600	1800		
ТПВР	600	1800	IV	-

Примечания к таблице 15:

(1) – Указаны предельные значения, конкретный диапазон, в зависимости от конструктивной модификации, указан в паспорте датчика.

(2) – Значение дрейфа зависит от конструктивной модификации и приведено в руководстве по эксплуатации

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационной документации типографским способом (в левом верхнем углу), а также при помощи наклейки на корпус датчиков температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки указан в таблице 16.

Таблица 16

Наименование	Кол-во	Примечание
Датчик температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex	1 шт.	исполнение - в соответствии с заказом
Паспорт	1 экз.	на каждую штуку
Руководство по эксплуатации	1 экз.	на партию в один адрес
Методика поверки	1 экз.	на партию в один адрес, для датчиков, с установленными ИП и для ТПВР

Поверка

осуществляется по документу МП 62293-15 «Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ех, ТПРТ Ех. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС», 04.06.2015г..

Основные средства поверки приведены в таблице 17.

Таблица 17

Наименование	Основные характеристики
Термостаты переливные прецизионные серии ТПП-1	Диапазон от минус 75 до плюс 300 °С, нестабильность поддержания температуры не более $\pm 0,01$ °С
Термостат с флюидизированной средой FB-08	Диапазон от 50 до 700 °С, нестабильность поддержания температуры не более $\pm 0,08$ °С
Горизонтальная трубчатая печь МТП-2М-50-500	Диапазон от 100 до 1200 °С, нестабильность поддержания температуры не более $\pm 0,1$ °С/мин
Высокотемпературная печь ВТП 1600-1	Диапазон воспроизводимых температур от 300 до 1600 °С, нестабильность поддержания температуры не более $\pm 0,4$ °С/мин
Эталонные термометры сопротивления ПТСВ, ЭТС-100	Диапазон измеряемой температуры от – 200 до + 660 °С, 3 разряд, согласно ГОСТ 8.558-2009
Преобразователь термоэлектрический эталонный ТППО	Диапазон измеряемой температуры от 300 до 1200 °С, 2 разряд, согласно ГОСТ 8.558-2009
Преобразователь термоэлектрический платиноводородный платиноводородный эталонный ПРО	Диапазон измеряемой температуры от 600 до 1600 °С, 2 разряд, согласно ГОСТ 8.558-2009
Измерители температуры многоканальные прецизионные МИТ 8	$\Delta t = \pm (0,004 + 10^{-5} \cdot t)$ °С – для термопреобразователей сопротивления, $\Delta t = \pm 0,15$ °С – для термоэлектрических преобразователей
Калибратор - измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ–2000	Пределы допускаемой основной погрешности измерений: $\Delta I = \pm (10^{-4} \cdot I + 1)$ мкА, $\Delta U = \pm (7 \cdot 10^{-5} \cdot U + 3)$ мкВ воспроизведения: $\Delta U = \pm (7 \cdot 10^{-5} \cdot U + 3)$ мкВ, $\Delta R = \pm 0,025$ Ом

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в руководстве по эксплуатации датчиков температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ех, ТПРТ Ех

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ех, ТПРТ Ех

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.

ГОСТ 30232-94 Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие технические требования».

ASTM E230/E230M-11e1 Стандартные функции и таблицы термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) для стандартных термопар.

ТУ 4211-005-10854341-2015 «Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ех, ТПРТ Ех. Технические условия».

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры.

ГОСТ 8.338-2002 ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТЕСЕЙ»
(ООО «ПК «ТЕСЕЙ»)

ИНН 4025016433

Юридический адрес: 249037, г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина 144, офис 72

Почтовый адрес: 249037, Калужская обл., г. Обнинск-7, а/я 7077

Тел./факс: (48439) 9-37-41, 9-37-42, 9-37-43

E-mail: zakaz@tesey.com, web: www.tesey.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский
научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д.46

Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в
целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

М.п.

« 26 »

11

2015 г.